

**Dovází: GALI spol. s r.o.**

Ke Stadionu 179, Semily 513 01

Tel. 481 689 050

Fax. 481 689 051

E-mail: [info@gali.cz](mailto:info@gali.cz)

**Vyrábí: Savyon Diagnostics Ltd.**

3 Habosem St. Ashdod 77610

ISRAEL

Tel. +972.8.8562920

Fax. +972.8.8523176

E-mail: [support@savondiagnositics.com](mailto:support@savondiagnositics.com)

#### Použití

SeroFIA™ C.psittaci je semi-kvantitativní imunofluorescenční test pro diferenciací stanovení specifických IgG, IgA a IgM protilátek proti *C.psittaci* v jediném vzorku lidského séra.

#### Pro In Vitro diagnostické účely.

#### Úvod

Chlamydia, rod vysoce specializovaných gram-negativních bakterií, tvoří čtyři druhy: *Ch. trachomatis*, *Ch.pneumoniae* (TWAR), *Ch. psittaci* a *Ch. pecorum*.

*Ch. trachomatis* je známa v 15 sérotypech, které obsahují v různém stupni imunogenní epitopy.

*Ch. trachomatis* je nejčastějším původcem sexuálně přenosných onemocnění. Je původcem negonokokové uretritidy (NGU) a epididymitis u mužů, cervitidy, uretritidy a zánětů dutiny pánevní u žen, Reiterova syndromu u HLA-B27 haplotypových jedinců a neonatální konjunktivitidy a pneumonie u novorozenců (2-6).

*Ch. pneumoniae* je důležitý respirační patogen, bývá nalezena asi u 10 % starších dospělých s „community acquired“ pneumonií. *Ch. pneumoniae* je asociována s infekcemi horních a dolních cest dýchacích, pneumonií, astmatem, bronchitidou, faryngitidou, výskytem srpkovitých erytrocytů, koronárním srdečním onemocněním a Guillain-Barre syndromem (7-9).

*Ch. psittaci* jsou primárními patogeny různých druhů živočichů. Měkkýši, ptáci, savci, mohou být důvodem některých případů pneumonií.

V mnoha diagnostických laboratořích se v diagnostice chlamydiových infekcí rutinně používá sérologických testů. Sérologické testy slouží jako neinvazivní postupy k identifikaci distálních a chronických chlamydiových infekcí (10,11), kde přímé detekční metody jsou zřídka



## SeroFIA™ C.psittaci

### Imunofluorescenční test na detekci specifických IgG, IgA a IgM protilátek proti *C. psittaci* v lidských sérech.

Savyon Diagnostics LTD.

Souprava pro 105 stanovení  
(Katalogové číslo 570-01)

Skladovat při teplotách 2°C až 8°C. Nezmrazovat.  
Pouze pro in vitro diagnostické použití.

úspěšné. Navíc, přítomnost určitého typu protilátek může také indikovat stav onemocnění. Primární chlamydiová infekce je charakteristická predominantní IgM odpovědí za 2-4 týdny a následnou IgG a IgA odpovědí za 6-8 týdnů. Po akutní infekci *Ch. pneumoniae* mizí IgM protilátky obvykle za 2-6 měsíců (12), titry IgG protilátek stoupnou a obvykle pomalu klesají, zatímco IgA protilátky mají tendenci rychle vymizet (13).

Sekundární chlamydiové infekce jsou charakterizovány absencí IgM odpovědi a okamžitou IgG a IgA odpovědí (9). Prokázalo se, že IgA protilátky jsou vhodným imunologickým znakem primární chronické a rekurentní infekce. Tyto protilátky obvykle klesají rychle k základním hladinám v důsledku léčení a eradikace chlamydiové infekce (1-6, 10, 11).

Persistence zvýšených titerů IgA protilátek se obvykle považuje za známku chronické infekce (13). Studie provedená se souborem starších pacientů s respiračními infekcemi prokázala, že pětina infekcí *Ch. pneumoniae* vymizela bez průkazu specifických IgA (14). IgG protilátky persistují dlouho a klesají velmi zvolna. Z toho důvodu přítomnost IgG protilátek indikuje hlavně chlamydiovou infekci v neurčitěm čase. Nicméně čtyřnásobný vzestup IgG specifických protilátek nebo jejich vysoká hladina mohou indikovat nastupující chronickou nebo systémovou infekci.

SeroFIA™ C.psittaci je makro-IF test založený na principu MIF. Podobně jako MIF používá SeroFIA™ jako antigen purifikovaná elementární tělíska *C. psittaci* (SZ-1).


#### Princip testu

- Purifikovaná elementární tělíska (EBs) *C.psittaci* jsou fixována na jamky sklíček.
- Naředěná séra pacientů se inkubují 30 min. při 37°C v jamkách.

- Promytím se odstraní nenavázané složky séra.
- Aplikuje se fluoresceinem konjugovaný anti-lidský IgG, IgA nebo IgM. Inkubuje se 30min. při 37°C.
- Nenavázaný konjugát se odstraní promytím.
- Následuje sušení skel a montování, přidají se tři kapky montovacího média.
- Sklíčka se prohlížejí použitím fluorescenčního mikroskopu. Pozitivní reakce je jasná jablkově zelená fluorescence EBs na tmavém pozadí.
- Pro kvalitativní stanovení je dostatečné jediné ředění séra. Pro semikvantitativní stanovení je nutno použít titraci do konečného ředění.

#### Souprava obsahuje

- 1. Reakční skříčka (3x7 jamek):** Skříčka jsou kautovaná antigenem *C. psittaci*. Každé skříčko je zabaleno v hliníkovém obalu se silikagelem. **5 x**

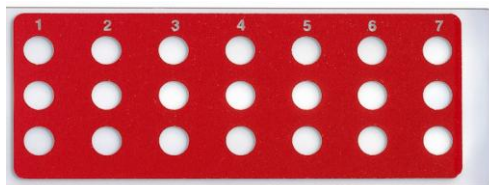

- 2. Koncentrovaný promývací pufr (x20):** PBS-Tween pufr, (pH 7.4-7.6) obsahuje NaCl, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> a Tween 20. **1 lahvička, 100ml**

- 3. Roztok na ředění sér:** PBS pufr. Obsahuje želatínu, hovězí sérový albumin, MgCl<sub>2</sub> a <0.1% azidu sodného. **1 lahvička, 80ml**

- 4. Negativní kontrola:** Lidské sérum bez obsahu protilátek IgG, IgA, a IgM k *C. pneumoniae*, *C. trachomatis*, *C. psittaci*. Obsahuje <0.1% azidu sodného. Neředí se. **1 lahvička, 0.5 ml**

- 5. IgG Positivní Kontrola:** Lidské sérum pozitivní na IgG protilátky k *C. psittaci*. Obsahuje <0.1% azidu sodného. Neředí se. **1 lahvička, 0.2ml**

- 6. IgA Positivní Kontrola:** Lidské sérum pozitivní na IgA protilátky k *C. psittaci*. Obsahuje <0.1% azidu sodného. Neředí se. **1 lahvička, 0.2ml**

- 7. IgM Positivní Kontrola:** Lidské sérum pozitivní na IgM protilátky k *C. psittaci*. Obsahuje <0.1% azidu sodného. Neředí se. **1 lahvička, 0.2ml**

- 8. IgG FITC-Conjugát:** Fluoresceinem značený králičí anti-lidský IgG (γ – řetězec specifický). Neředí se. **1 lahvička, 3.3ml**

- 9. IgA FITC-Conjugát:** Fluoresceinem značený králičí anti-lidský IgA (alfa – řetězec specifický). Neředí se. **1 lahvička, 3.3ml**

- 10. IgM FITC-Conjugát:** Fluoresceinem značený králičí anti-lidský IgM (μ – řetězec specifický). Neředí se. **1 lahvička, 3.3ml**

- 11. IgG Inaktivační reagent:** anti-lidské IgG s obsahem <0.1% azidu sodného. **(Pouze pro IgM.)** **1 lahvička, 4ml**

- 12. Montovací tekutina:** Obsahuje <0.1% azidu sodného. **1 kapací lahvička, 1.5ml**

- 13. Krycí skříčka** **1 unit**

- 14. Návod k použití** **1**

#### Potřebný materiál, který není součástí soupravy.

1. Čistá mikrotitrační destička nebo zkumavky na ředění sér.
2. Centrifuga
3. Nastavitelné mikropipety (5 – 50, 50 – 200, 200 – 1000 mikrolitrů) a příslušné špičky
4. Odměrný válec na 1 L
5. Vortex třepačka
6. Vodní lázeň 37°C s víkem nebo vlhká komůrka umístěná v termostatu 37°C
7. Plastová miska pro inkubaci skříček
8. Destilovaná nebo redestilovaná voda na ředění koncentrovaného promývacího pufru
9. Plastová stříčka na promývání
10. Nosič skříček a barvicí kyveta
11. Časoměřič
12. Fluorescenční mikroskop s filtry vhodnými pro hodnocení FITC fluorescence se zvětšením 40x až 100x

#### Upozornění a zásady bezpečnosti

Pouze pro in vitro diagnostické použití.

1. Tato souprava obsahuje lidská séra, která byla testována technikami podle FDA. Séra jsou negativní na HBsAg a protilátky proti HCV a HIV, nicméně, jelikož žádná známá metoda nemůže zaručit s úplnou jistotou, že výrobky derivované z lidské krve nepřenesou infekci, se všemi komponenty z lidské krve, obsaženými v této soupravě se musí zacházet jako s potenciálně infekčním sérem nebo krví, způsobem identickým (nebo podobným) s doporučením publikovaným v CDC/NIH manuálu „Biobezpečnost mikrobiologických a lékařských laboratořích“, 1988.
2. Chlamydiový antigenní materiál, kterým jsou koutovaná skříčka, byl inaktivován a obsah živých organismů je nedetekovatelný. Nicméně, jelikož žádná známá metoda nemůže zaručit s úplnou jistotou, že produkty derivované z patogenních organismů nepřenesou infekci, se skříčky se musí zacházet jako s potenciálním biohazard materiálem, tj.

způsobem publikovaným v CDC/NIH manuálu (viz čl. 1).

3. Azid sodný tvoří explozivní azidy olova nebo mědi v potrubí laboratorních odpadů. Aby se předešlo akumulaci těchto sloučenin, laboratorní výlevky se musí promývat velkým objemem vody.
4. Pipetování ústy je nepřípustné.
5. Žádná z reagensů této soupravy nesmí přijít do styku s pokožkou.
6. Při provádění testu a manipulaci se séry je nutné používat ochranné gumové rukavice. Po sejmutí rukavic je nutné pečlivě umýt ruce.
7. Zařízení, tekutiny a předměty, které přišly do přímého styku z lidskými séry, se považují za potenciálně kontaminované. Musí se sterilizovat nebo inaktivovat po použití a před mytím nebo vyřazením po použití. Inaktivace může být provedena buď autoklávováním při 121°C nejméně 1 h nebo vystavením účinku roztoku chlornanu sodného v 5% finální koncentraci (po dobu nejméně 30 min.)
8. FITC – konjugát obsahuje Evansovu modř, která je kancerogenní. Roztok nesmí přijít do styku s pokožkou a očima.
9. Montovací médium obsahuje korozivní látky. Nesmí přijít do styku s pokožkou a nesmí dojít k jeho inhalaci. V případě kontaktu s pokožkou a očima je nutné provést okamžitý oplach (výplach) nadbytkem vody.

#### Uchovávání a trvanlivost reagensů

Všechny dodávané materiály je nutno skladovat při teplotě 2 až 8°C. Reagensy, uchovávané při teplotě 2 až 8°C, jsou stabilní do data expirace, vyznačeného na obalu soupravy. Nepoužívejte složky soupravy po datu expirace.

Expozice složek soupravy obvyklejší teplotě po dobu několika hodin nezpůsobí zničení reagensů.

**Nevystavujte reagensy silnému světlu. Reagensy nezmrázujte.**

#### Odběr vzorků a příprava vzorků

##### Odběr vzorků

Vzorky séra se odebírají asepticky standardními technikami. Tepelně inaktivovaná séra nemohou být použita. Nedoporučuje se použití lipemických, zakalených a kontaminovaných sér. Drobné částice a sraženiny v séru mohou způsobovat chybné výsledky. Tyto vzorky by měly být před stanovením vyčiřeny centrifugací nebo filtrací.

#### Skladování

Vzorky by se měly skladovat při teplotě 2-8°C pokud jsou testovány během 7 dní (doporučuje se přidavek 0,1% azidu sodného). Pro delší uchování je nutno alikvoty séra uchovávat při teplotě -20°C. Vyhněte se opakovanému mrazení a rozmrazování séra.

#### Validita testu

Aby byl test platný, musí být splněna následující kritéria. Jestliže kontroly nemají výše uvedené charakteristiky, test se považuje za neplatný a musí být zopakován.

**Pozitivní kontroly** vykazují střední až intenzivní jablkově zelenou fluorescenci partikulí elementárních tělísek *C.psittaci*.

**Negativní kontrola** vykazuje zanedbatelnou reaktivitu (barvení) s *C.psittaci*.

#### Interpretace a význam výsledků

Doporučuje se hodnotit jako prvé kontrolní jamky, aby se zajistila správná interpretace výsledků.

Fluorescence klinických vzorků se hodnotí následujícím způsobem:

+ Střední až intenzivní, ostrá nebo difuzní jablkově zelená fluorescence elementárních tělísek.

± Fluorescence elementárních tělísek je zřetelná, ale tlumená. Považuje se za „endpoint“ titru séra. Titr daného séra je definován jako nejvyšší ředění, které ještě vykazuje zřetelnou fluorescenci. Další ředění má vykazovat fluorescenci jako negativní sérum.

- Bez fluorescence nebo se slabou fluorescencí pozadí bez zřetelné morfologie chlamydií.

#### Pracovní postup pro IgG

##### Příprava vzorků

Pro prvotní skrínění se séra ředí v poměru 1:64 přidáním 10 µl séra do 630 µl ředícího roztoku na séra (Serum Diluent).

Pro stanovení titrů („endpoint“ titrace) se séra ředí (počínaje od ředění 1:64) ředící dvojkovou řadou.

*Poznámka: Součástí každého běhu by měla být jedna jamka s negativní a jedna jamka s IgG pozitivní kontrolou.*

1. Před zahájením testu se sklíčka, reagentie a séra pacientů nechají vytemperovat při laboratorní teplotě.
2. Koncentrovaný promývací pufr se ředí v poměru 1:20 přidáním 50 ml koncentrovaného promývacího pufru do 950 ml deionizované nebo destilované vody. Naředěný pufr se může uchovávat při teplotě 2 až 8°C nejvýše po dobu dvou týdnů.
3. Do příslušných jamek se pipetuje 10 µl kontrol nebo naředěného séra.
4. Sklíčka se inkubují ve vlhké komůrce při 37°C po dobu 30 minut.
5. Sklíčka se vyjmou z vlhké komůrky a každé sklíčko se jemně opláchne proudem naředěného promývacího pufru pomocí stříčky. Sklíčka se promyjí ponořením do kyvety osahující promývací pufr Po 10 min se vyjmou, ponoří do destilované vody, vyjmou a ponechají na vzduchu schnout.
6. Do každé jamky se pipetuje 10 µl FITC konjugátu.
7. Inkubuje se při teplotě 37°C po dobu 30 minut.
8. Opláchnutí a promytí skel se opakuje podle kroku 5.
9. Podél středu každého sklíčka se kápnou 3 kapky montovacího roztoku. Jamky se překryjí krycím sklem. Případné vzduchové bubliny se odstraní jemným tlakem na krycí sklíčko.
10. Výsledky se hodnotí pomocí fluorescenčního mikroskopu při zvětšení 400x až 1000x. Nejlepší výsledky dává hodnocení preparátů v den jejich přípravy. Jestliže to není možné, montované preparáty se mohou skladovat ve tmě při 2 – 8°C po dobu nejvýše tří dnů.

Fluorescence při titru 1:64	Interpretace
+	<b>Přítomnost specifických IgG protilátek k <i>C.psittaci</i>.</b> Doporučuje se end-point titrace k rozlišení mezi současnou, nedávnou nebo dříve proběhlou infekcí <sup>1</sup> .
±	<b>Indikuje možnou expozici k <i>C.psittaci</i>.</b> Doporučuje se testování druhého vzorku za 2-4 týdny <sup>2</sup>

-	<b>Negativní.</b> Nedetekovatelné IgG protilátky k <i>C.psittaci</i> .
---	--

1. Titr >64 vypovídá o současné nebo proběhlé infekci *C.psittaci*.
2. Pokud se odebírá druhý vzorek, měl by být vždy testován současně s prvním. Pokud opět dostanete hraniční výsledek, vzorek se považuje za negativní.

#### Upozornění:

Ve vzácných případech může být pozorována na jednom nebo více chlamydiových antigenech jasná a densní fluorescence velmi malých partikulí (menších než elementární tělíška). Tato fluorescence může představovat reaktivitu k lipopolysacharidům. Je nutno provést testování IgA a IgM protilátek nebo testování druhého vzorku séra, odebraného po 2-3 týdnech. Vzorek se považuje za negativní, jestliže IgM a IgA jsou negativní a IgG výsledky jsou opakovaně shodné.

#### Pracovní postup pro IgA

##### **Příprava vzorků**

Pro prvotní skrínig se séra ředí v poměru 1:32 přidáním 10 µl séra do 310µl ředícího roztoku na séra (Serum Diluent) .

Pro stanovení titrů („endpoint“ titrace) se séra ředí (počínaje od ředění 1:32) ředící dvojkovou řadou.

*Poznámka: Součástí každého běhu by měla být jedna jamka s negativní a jedna jamka s IgA pozitivní kontrolou.*

1. Před zahájením testu se sklíčka, reagentie a séra pacientů nechají vytemperovat při laboratorní teplotě.
2. Koncentrovaný promývací pufr se ředí v poměru 1:20 přidáním 50 ml koncentrovaného promývacího pufru do 950 ml deionizované nebo destilované vody. Naředěný pufr se může uchovávat při teplotě 2 až 8°C nejvýše po dobu dvou týdnů.
3. Do příslušných jamek se pipetuje 10 µl kontrol nebo naředěného séra.
4. Sklíčka se inkubují ve vlhké komůrce při 37°C po dobu 30 minut.
5. Sklíčka se vyjmou z vlhké komůrky a každé sklíčko se jemně opláchne proudem naředěného promývacího pufru pomocí stříčky. Sklíčka se promyjí ponořením do kyvety osahující promývací pufr Po 10 min se vyjmou, ponoří do destilované vody, vyjmou a ponechají na vzduchu schnout.

- Do každé jamky se pipetuje 10 µl FITC konjugátu.
- Inkubuje se při teplotě 37°C po dobu 30 minut.
- Opláchnutí a promytí skel se opakuje podle kroku 5.
- Podél středu každého sklíčka se kápnou 3 kapky montovacího roztoku. Jamky se překryjí krycím sklem. Případné vzduchové bubliny se odstraní jemným tlakem na krycí sklíčko.
- Výsledky se hodnotí pomocí fluorescenčního mikroskopu při zvětšení 400x až 1000x. Nejlepší výsledky dává hodnocení preparátů v den jejich přípravy. Jestliže to není možné, montované preparáty se mohou skladovat ve tmě při 2 – 8°C po dobu nejvýše tří dnů.

Fluorescence při titru 1:32	Interpretace
+	<b>Přítomnost specifických IgA protilátek k <i>C.psittaci</i>.</b> Titr 1:32 svědčí o pravděpodobném výskytu infekce
±	<b>Indikuje možnou expozici k <i>C.psittaci</i>.</b> Doporučuje se testování druhého vzorku za 2-4 týdny <sup>2</sup>
-	<b>Negativní.</b> Nedetekovatelné IgA protilátky k <i>C.psittaci</i> .

- Pokud se odebírá druhý vzorek, měl by být vždy testován současně s prvním. U pacientů s probíhající infekcí *C.psittaci*, by mělo dojít ke zvýšení titru protilátek. Pokud opět dostanete hraniční výsledek, vzorek se považuje za negativní.

### Upozornění:

Ve vzácných případech může být pozorována na jednom nebo více chlamydiových antigenech jasná a densní fluorescence velmi malých partikulí (menších než elementární tělíska). Tato fluorescence může představovat reaktivitu k lipopolysacharidům. Je nutno provést testování IgG a IgM protilátek nebo testování druhého vzorku séra, odebraného po 2-3 týdnech. Vzorek se považuje za negativní, jestliže IgM a IgG jsou negativní a IgA výsledky jsou opakovaně shodné.

## Pracovní postup pro IgM

### Příprava vzorků

- Přidejte 5µl séra pacienta ke 45µl IgG Inaktivačního reagentu. Dobře promíchejte.
- Ke každým 50µl takto předpřipraveného séra přidejte 50µl roztoku k ředění sér. Takto získaná séra mají konečné ředění 1:20.

Pro stanovení titrů („endpoint“ titrace) se séra ředí počínaje od ředění 1:20.

*Poznámka: Součástí každého běhu by měla být jedna jamka s negativní a jedna jamka s IgM pozitivní kontrolou.*

- Před zahájením testu se sklíčka, reagentie a séra pacientů nechají vytemperovat při laboratorní teplotě.
- Koncentrovaný promývací pufr se ředí v poměru 1:20 přidáním 50 ml koncentrovaného promývacího pufru do 950 ml deionizované nebo destilované vody. Naředěný pufr se může uchovávat při teplotě 2 až 8°C nejvýše po dobu dvou týdnů.
- Do příslušných jamek se pipetuje 10 µl kontrol nebo naředěného séra.
- Sklíčka se inkubují ve vlhké komůrce při 37°C po dobu 30 minut.
- Sklíčka se vyjmou z vlhké komůrky a každé sklíčko se jemně opláchne proudem naředěného promývacího pufru pomocí stříčky. Sklíčka se promyjí ponořením do květy osahující promývací pufr Po 10 min se vyjmou, ponoří do destilované vody, vyjmou a ponechají na vzduchu schnout.
- Do každé jamky se pipetuje 10 µl FITC konjugátu.
- Inkubuje se při teplotě 37°C po dobu 30 minut.
- Opláchnutí a promytí skel se opakuje podle kroku 5.
- Podél středu každého sklíčka se kápnou 3 kapky montovacího roztoku. Jamky se překryjí krycím sklem. Případné vzduchové bubliny se odstraní jemným tlakem na krycí sklíčko.
- Výsledky se hodnotí pomocí fluorescenčního mikroskopu při zvětšení 400x až 1000x. Nejlepší výsledky dává hodnocení preparátů v den jejich přípravy. Jestliže to není možné, montované preparáty se mohou skladovat ve tmě při 2 – 8°C po dobu nejvýše tří dnů.

Fluorescence při titru 1:20	Interpretace
+	<b>Přítomnost specifických IgM protilátek k <i>C.psittaci</i>.</b> Titr $\geq 1:20$ svědčí o pravděpodobném výskytu infekce
±	<b>Indikuje možnou expozici k <i>C.psittaci</i>.</b> Doporučuje se testování druhého vzorku za 2-4 týdny <sup>1</sup>
-	<b>Negativní.</b> Nedetekovatelné IgM protilátky k <i>C.psittaci</i> .

2. V případě hraničního výsledku se za 2-4 týdny odebrá druhý vzorek. Ten by měl být vždy testován současně s prvním. Pokud opět dostanete hraniční výsledek, vzorek se považuje za negativní.

#### Význam IgM end-point titrace

Endpoint titrace se provádí, jestliže jsou vyžadovány semi-kvantitativní výsledky.

**Ke získání kompletního protilátkového profilu, by se mělo testovat ve třídě IgG, IgA i IgM.**

**Interpretace výsledků založených na detekci IgA, IgM a IgG protilátek.**

Hladina protilátek <i>C.psittaci</i>			Interpretace výsledků
IgM	IgG	IgA	
Negativní	Negativní	Negativní	Neindikuje infekci <i>C.psittaci</i>
Positivní	Negativní nebo Positivní	Negativní nebo Positivní	Indikuje probíhající infekci
Negativní	Positivní	Negativní	Indikuje proběhlou nebo současnou infekci.
Negativní	Positivní nebo Negativní	Positivní	Vypovídá o současné nebo chronické infekci

#### Omezení testu

- Konečná diagnóza nemůže být určena na základě výsledku jediného sérologického testu – v úvahu se musí brát všechny klinické a laboratorní údaje.
- Vzorky odebrané příliš brzy v průběhu primární infekce nemusí obsahovat

detekovatelné protilátky. Jestliže chlamydiová infekce je suspektní, je nutno vyšetřit (paralelně s prvním sérem) druhý vzorek séra, odebraného o 14 -21 dní později.

- Reaktivita séra s více druhy chlamydií může být způsobena expozicí více než jednomu druhu nebo přítomností křížově reagujících protilátek.
- Optika mikroskopu a podmínky světelného zdroje a jeho typ mohou ovlivnit intenzitu fluorescence a výšku titru.

#### Charakteristika účinnosti

Studie byla provedena v nezávislém lékařském zařízení. Byla použita séra suspektních pacientů infikovaných *C. psittaci*.

#### Výsledky získané použitím soupravy IgG SeroFIA™ vs. Reference MIF

MIF	Positivní	Negativní	Celkem
<b>SeroFIA™</b>			
Positivní	18	1	19
Negativní	2	10	12
Celkem	20	11	31

Sensitivita:  $18/20 \times 100 = 90\%$

Specifická:  $10/11 \times 100 = 91\%$

Celková shoda:  $28/31 \times 100 = 90\%$

#### Výsledky získané použitím soupravy IgA SeroFIA™ vs. Reference MIF

MIF	Positivní	Negativní	Celkem
<b>SeroFIA™</b>			
Positivní	1	4	5
Negativní	1	24	25
Celkem	2	28	30

Specifická:  $24/28 \times 100 = 88\%$

Celková shoda:  $25/30 \times 100 = 83\%$

Poznámka: Senzitivita nemohla být stanovena vzhledem k malému počtu pozitivních vzorků.

#### Výsledky získané použitím soupravy IgM SeroFIA™ vs. Reference MIF

MIF	Positivní	Negativní	Celkem
<b>SeroFIA™</b>			
Positivní	3	2	5
Negativní	0	26	26
Celkem	3	28	31

Sensitivita:  $3/3 \times 100 = 100\%$

Specifická:  $26/28 \times 100 = 93\%$

Celková shoda:  $29/31 \times 100 = 94\%$

#### Literatura

1. **Piura, B., Sarov, I., Sarov, B., Kleinman, D., Chaim, W. and Insler, V.** (1985) Serum IgG and IgA antibodies specific for Chlamydia trachomatis in salpingitis patients as determined by the immunoperoxidase assay. Eur. J. Epidemiol. 1: 110-116.
2. **Tsunekawa, T. and Kumamoto, Y.** (1989) A study of IgA and IgG titers of C.trachomatis in serum and prostatic secretion in chronic prostatitis. J.J.A. Inf. Dis. 63(2): 130-137.
3. **Kaneti, J. et al** (1988) IgG and IgA antibodies specific for Chlamydia trachomatis in acute epididymits. Europ. Urol. 14: 323-327.
4. **Kletter, Y., Caspi, D., Yarom, M., Sarov, B., Sarov I., and Tanay, A.** (1988) Serum IgA and IgG Antibodies Specific to Chlamydia in Patients with Rieter's Syndrome (RS) In: Proceedings of The European Society for Chlamydia Research, Societa Editrice Esculapio, Bologna, p.170.
5. **Stutman, H.R., Rettig, P.J. and Reyes, S.** (1984) Chlamydia trachomatis as a cause of Pneumonitis and pleural effusion. J. Pediat. 104: 588-591.
6. **Paran, H., Heimer, D. and Sarov, I.** (1986) Serological, clinical and radiological findings in adults with broncho- pulmonary infections caused by Chlamydia trachomatis. Isr. J.Med. Sci. 22: 823-827.
7. **Grayston J. T., Campbell, L.A., Kuo, C.C., Mordhorst, C.H., Saikku, P., Thom, D.H. and Wang, S.P.** (1990). A new respiratory tract pathogen. Chlamydia pneumoniae strain TWAR. J. Infect. Dis. 161:618-625.
8. **Hahn D. L., Dodge, R. W. and Golubjatnikow, R.** (1991). Association of Chlamydia pneumoniae (strain TWAR) infection with wheezing, asthmatic bronchitis, and adult-onset asthma. JAMA 266: 225-230
9. **Saikku P., Mattila, K., Nieminen, M.S., Huttunen, J.K., Leinonen, M., Ekman, M.R., Makela, P.H., and Valtonen, V.** (1988). Serological evidence of an association of a novel Chlamydia, TWAR, with chronic coronary heart disease and acute myocardial infection. Lancet II: 983-986.
10. **Sarov, I., Kleinman, D., Cevenini, R., Holcberg, G., Potashnik, G., Sarov, B. and Insler, V.** (1986) Specific IgG and IgA antibodies to Chlamydia trachomatis in infertile women. Int. J. Fertil. 31 (3): 193-197.
11. **Puolakkainen, M., Saikku, P., Leinonen, M., Nurminen, M., Vaananen, P. and Makela, P.H.** (1984) Chlamydia pneumoniae and its serodiagnosis in infants. J. Infect. Dis. 149: 598-604.
12. **Grayston, J.T., L.A. Campbell, C.H. Mordhorst, P. Saikku, D. Thom and S.P. Wang.** (1989) A New Respiratory Pathogen: Chlamydia pneumoniae Strain TWAR. J.Inf.Dis. 161: 618-25
13. **Saikku, P.,M. Leinonen, L. Tenkanen, E. Linnanmaki, M-R Ekman, V. Manninen, M. Manttari, M.H. Frick, J.K. Huttunen.** (1992) Chronic Chlamydiae pneumoniae Infection as a Risk Factor for Coronary Heart Disease in the Helsinki Heart Study. Ann. of Int. Med. 116: 273-278.
14. **Leinonen, M., H. Sryjala, P. Kujala and P. Saikku.** (1991). Serological diagnosis of Chlamydiae pneumoniae (Cpn) pneumoniae in

adults. In: Abstracts of 31st ICAAC, Chicago, Illinois, Sept 29 - Oct 2, 1991. Washington, D.C. Aner. Soc. Microbiol, p.209.



**European Authorized Representative: Obelis s.a.**  
 Av. De Tervuren, 34bte 44, B-1040 Brussels  
 Tel: +32.2.732.59.54 Fax: +32.2.732.60.03  
 E-mail: [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net) Mobile: +32.475.45.46.60